

上部消化管ビデオスコープ GIF-H290 (2013年製)





EVIS LUCERA

ELITE

OLYMPUS

GIF-H290

2301416

CAUTION: Wipe the electrical contacts before insertion.
注意: 電気接点は十分にふいてから使用してください。

上部消化管ビデオスコープ GIF-XP290N (2013年製)





EVISLUCCERA
ELITE

OLYMPUS
GIF-XP290N
2301351

CAUTION: Wipe the electrical contacts before insertion.
注意: 電気接点は十分に
拭いてから使用し
てください。

ビデオシステムセンター CV-290 (2013年製)



一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

一般的名称 内視鏡ビデオ画像プロセッサ

販売名 EVIS LUCERA ELITE


ビデオシステムセンター

OLYMPUS CV-290

電源入力 100V~ 50/60Hz 150VA

ト2

光源装置 CLV-290 (2013年製)

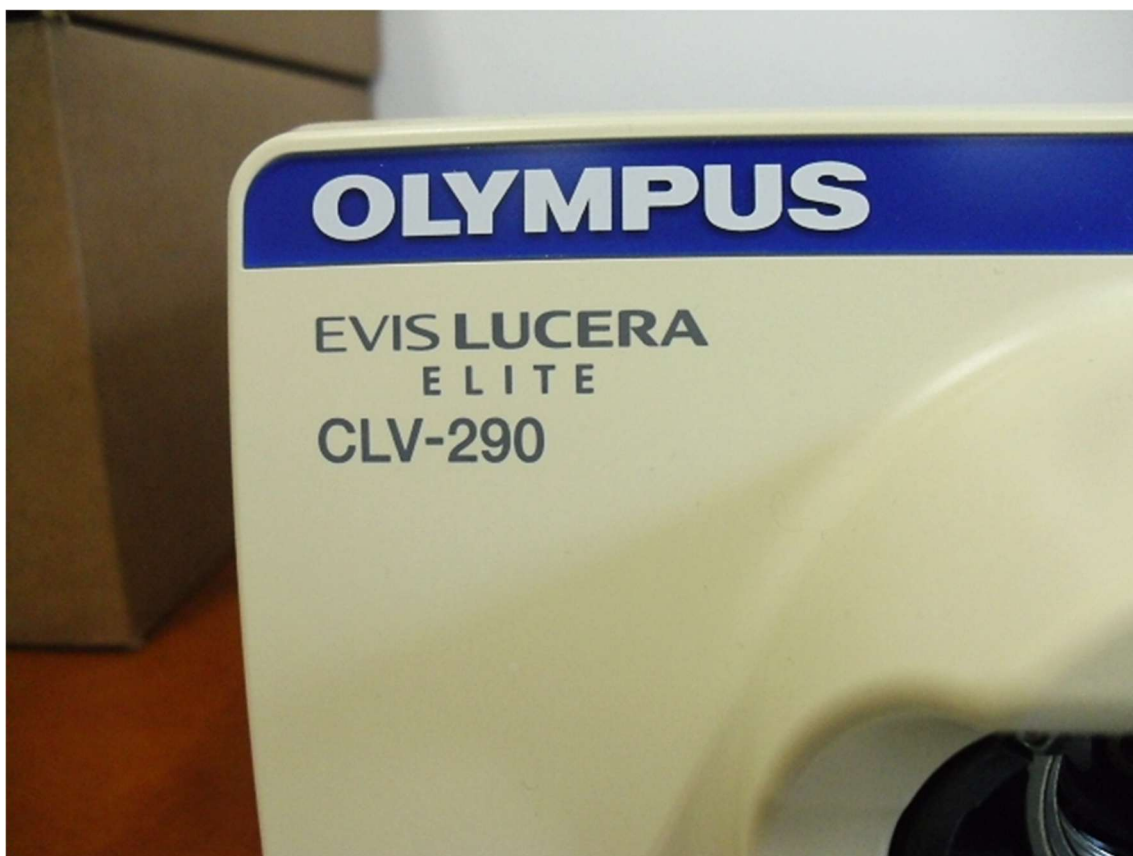

管理医療機器

/ 特定保守管理医療機器

一般の名称

送気送水機能付外部電源式

内視鏡用光源装置

販売名

EVIS LUCERA

ELITE

高輝度光源装置

OLYMPUS CLV-290